
SINCE 1983

CALLUS®

IMPLANT CARE SYSTEM

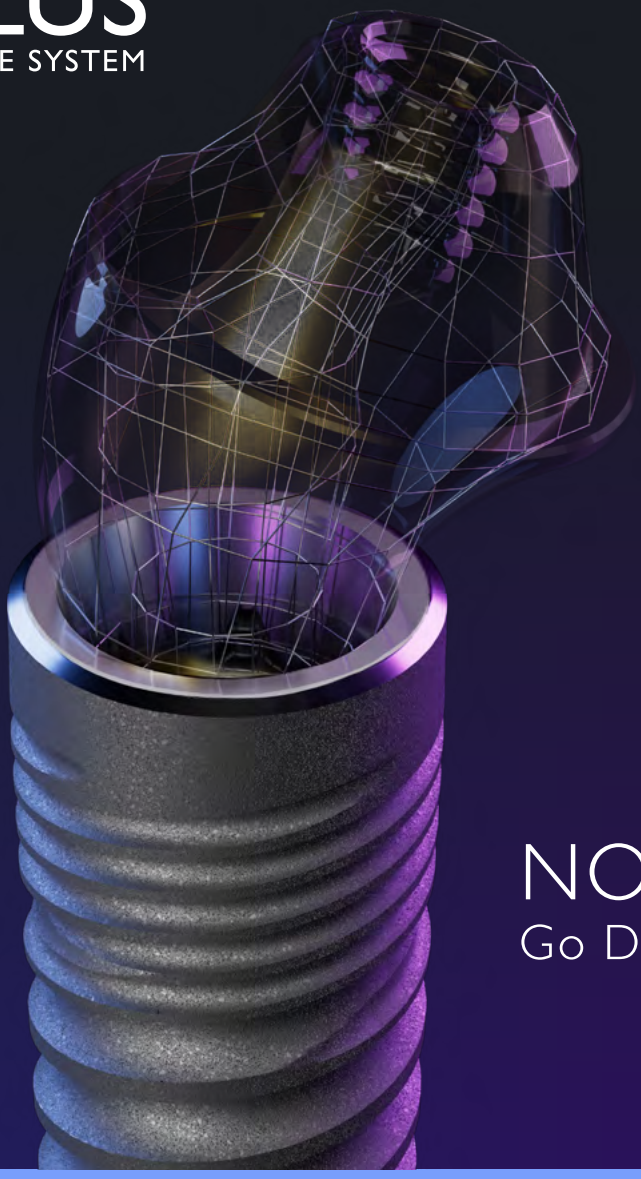

NO LIMITS

Go DIGITAL!

TERMÉK

KATALÓGUS

Smile for everyone

C 2026.05v01 HU

Tartalom

A CALLUS® IMPLANTÁCIÓS RENDSZER 3

CALLUS PRO 4
- Platform 4
- Felület 5
- Csomagolás, sterilitás 6
- Felhasználhatóság 7

IMPLANTÁTUM MÉRETVÁLASZTÉK 8
- Callus Pro Implantátumok 8

PROTETIKA 9

RAGASZTOTT PÓTLÁSOK 10
- Egyenes és szögtörött fejrészek 10
- Fordított kúpos fejrészek 10
- Pre-milled tömb 11

TITÁN BÁZISOK ÉS ÖNTHETŐ/BEÁGYAZHATÓ FEJRÉSZEK 12
- Króm-kobalt fejrészek alap öntéstechnológiához 12
- Titán bázisok 13
- Szögtörött Titán bázisok 14
- CEREC kompatibilis Titán bázis 14
- Szögtörött Titán bázis Tulajdonságok és előnyök 15

IDEIGLENES PÓTLÁSOK 16
- Titán ideiglenes felépítmények 16

KIVEHETŐ PÓTLÁSOK 17
- Gömb-retenciós felépítmények 17
- Tartozékok 17
- Locator 18
- Locator tartozékok 19

MULTI-UNIT FELÉPÍTMÉNYEK 20
- Egyenes és szögtört Multi-Unit felépítmények 20
- Multi-Unit kiegészítők 24

DIGITÁLIS PROTETIKAI KIEGÉSZÍTŐK 26
- Titán bázisok 26
- Szögtörött Titán bázisok 27
- CEREC kompatibilis Titán bázis 27
- Labor és intraorális scan body-k 28
- Pre-milled tömb 28
- Digitális laborimplantátumok 28

LABORIMPLANTÁTUMOK / RÖGZÍTŐCSAVAROK 29
- Laborimplantátumok (analóg) 29
- Rögzítőcsavarok 29

ÍNYFORMÁZÓK ÉS LENYOMATVÉTELI MŰCSONKOK 30
- Ínyformázók 30
- Lenyomatvételi műcsonkok 31

SEBÉSZETI TÁLCA 34
- Sebészeti műszerek 34

PROTETIKAI TÁLCA 38
- Protetikai műszerek 38



A CALLUS® Implantációs Rendszer

A CALLUS® Implantációs Rendszer nemzetközi együttműködés eredményeként jött létre 2018-ban. Európa harmadik legrégebbi implantációs vállalkozásának az 1983-ban alapított Denti System Kft-nek a szakmai tapasztalatait, hagyományait és tudását ötvözi nemzetközi szakemberek – szájsebészek, implantológusok és fogtechnikusok- gyakorlati, innovatív tudásával.

Implantátumainkat, műszereinket és protetikai alkatrészeinket Európa különböző pontjain Németországban, Spanyolországban és Olaszországban gyártjuk, míg a közös európai minőségbiztosítási követelmények tanúsítása Magyarországon történik. A nemzetközi kereskedelem központja a németországi Nürnbergben, míg a nagykereskedelmi raktár Magyarországon található.

Nemcsak a gyártásban, de a fejlesztések terén is együttműködünk a világ vezető fogászati szakembereivel, sebészeivel és technikusaival. Az orvostudományi egyetemekkel együtt végzett kutatási és fejlesztési tevékenység magában foglalja a termékek külső és belső kialakítását, az implantátum testrész-fejrész csatlakozásainak tesztelését, felületi módosítások kialakítását, illetve a fejlesztések in vivo és in vitro kipróbálását is. Ezek a klinikai vizsgálatok biztosítják számunkra azt az innovatív, modern tudást, amely termékeinkbe beépítve biztonságos hátteret nyújt a felhasználó orvosoknak már 40 éve.

Így a CALLUS® Implantációs Rendszer Európa egyik legmodernebb, digitális technológiák terén élenjáró implantációs rendszere lett, amely felhasználói és a betegek számára is fejlett, prémium minőségű fogászati implantációs megoldásokat kínál. A CALLUS® Implantációs Rendszer filozófiája, hogy a legjobb ár-érték arányú, könnyen használható és mind a betegek, mind a felhasználók számára elérhető termékeket biztosítson.

A CALLUS® Implantációs Rendszer kiemelten fontos célja a legmodernebb digitális technológiai alkalmazása, amely egyre egyszerűbbé és rugalmasan felhasználhatóvá teszi a rendszert a fogorvosok és fogtechnikusok számára.

A CALLUS® Implantációs Rendszerhez kapcsolódóan folyamatos oktatást és rendelkezésre állást biztosítunk a kiváló implantológiai megoldások elvégzéséhez.

A CALLUS® termékek CE 1639-jelöléssel rendelkeznek és megfelelnek a legmagasabb szabályozási követelményeknek.




CALLUS Pro

PLATFORM

A Callus PRO rendszer protetikai csatlakozását mély, 2x 12°-os kúp és 1.2 mm hosszúságú hatszög indexelés alkotja. A mély kúpos kapcsolat a biológiai zárás garantálásán túl a vékony implantátumok mechanikai ellenállását hivatott biztosítani. A digitális alapon készülő egyedi alkatrészek elérhetősége érdekében olyan, jól hozzáférhető és elterjedten alkalmazott kompatibilis implantátum-fejrész csatlakozást integráltunk, ami a világ szinte összes CAD/CAM rendszerében megtalálható. A 2x12°-os kúp nagyszerű egyensúlyt jelent biológiai zárás, stabilitás és platform switch tekintetében úgy, hogy nem kell az implantátum és protetikai elemek egymásba szorulásától tartanunk. Két platform átmérőt kínálunk, amiből a keskenyebb - még anatómiailag kedvezőtlen helyzetekben is kielégítő emergencia profil kialakítását teszi lehetővé - vékony implantátum esetén is szignifikáns platform switch mellett.

JELLEMZŐK

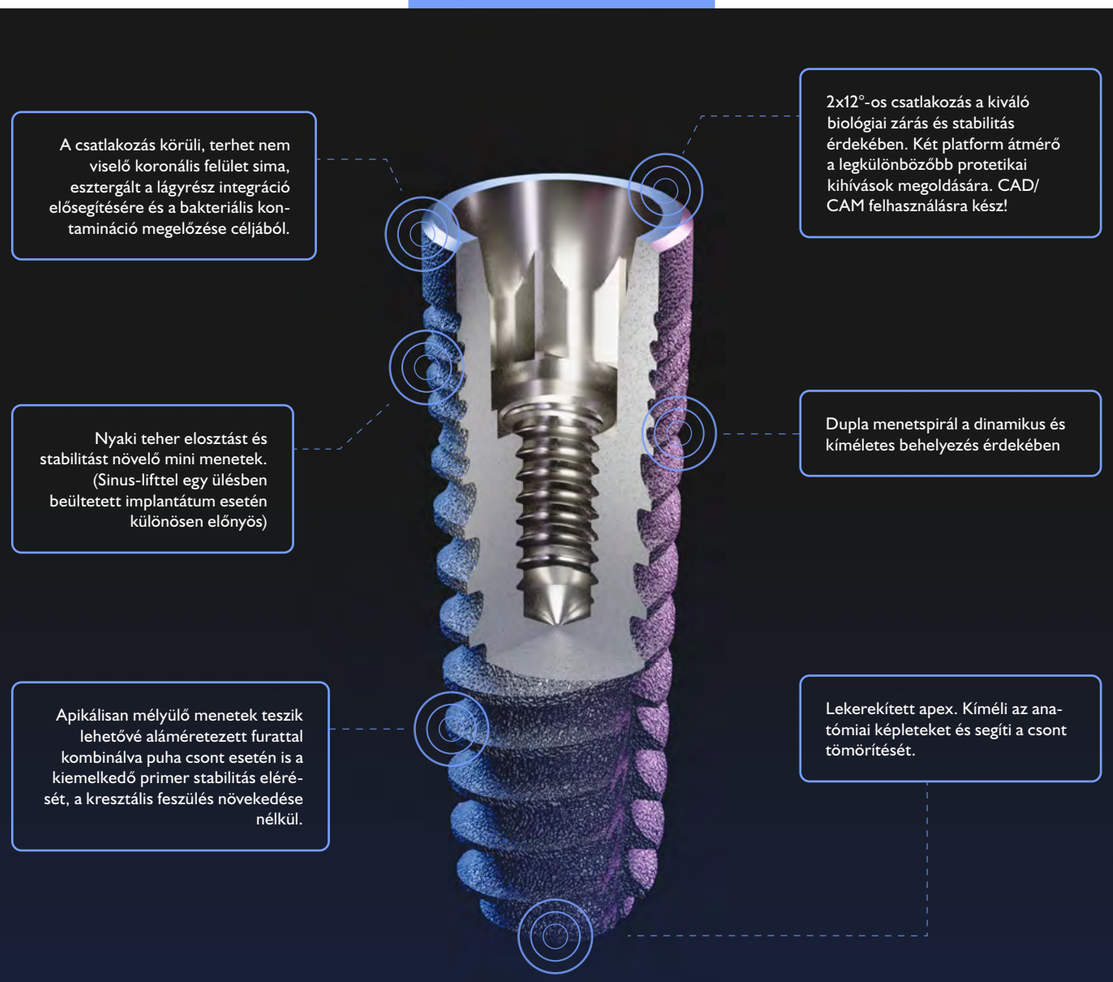

Teljes vertikális hosszában kezelt felület a magas, akár azonnali terhelést is lehetővé tevő stabilitás és a csontot kímélő kedvező teherelosztás érdekében.

Enyhén kúpos formájú implantátum test, ami aláméretezett párhuzamos furatban tömörítő funkciója révén segíti a megfelelő stabilitás elérését.

A csont keménysége és az elérni kívánt stabilitás függvényében megválasztott fúrási protokollal kombinálva univerzálisan alkalmazható implantátumtest forma.


FELÜLET

Tudományos kutatások bizonyítják, hogy egy optimálisan kialakított implantátumfelület elengedhetetlen a megfelelő osszeointegráció eléréséhez. Jól dokumentált, hogy a felszíni karakterisztika és a beültetett anyagok jellemzői nagymértékben befolyásolják az implantátum felszínével szomszédos szövetek gyógyulását. A CALLUS implantátumok Grade 4* minőségű, hidegen megmunkált titánól készülnek, ami kiemelkedő fizikai tulajdonságokkal és biokompatibilitással rendelkezik. A Callus implantátum felülete hibrid típusú, amit egy összetett folyamat révén érnek el. Homokfúvással és SBTE Active (*SLA™) termikus sav maratással hoznak létre mikropórusokat (2-7 mikron méretűek). Ez az egyedülálló eljárás nagy felületi tapadást biztosít, növeli a háromdimenziós felületet, így lehetővé téve az intenzívebb vér és plazma kötődést közvetlenül az implantátum mikropórusaiba, rögtön az implantátum behelyezése után. Az implantátum mikroszerkezete és érdessége, a homokfúvással és kettős savas maratási eljárással létrehozott felület biokompatibilis és oszteokonduktív, ami induktív hatással van a gazdaszervezet csontjával kialakuló kezdeti kapcsolatra. A legkorszerűbb felületkezelés biztosítja a lehető legjobb eredményeket.


A CALLUS felület előnyei:

- Gyorsított csontintegrációs folyamat
- Fokozott másodlagos stabilitás
- Rövidebb gyógyulási idő
- Nagyobb kiszámíthatóság


MEGFELEL A TUDOMÁNY JELENLEGI IRÁNYZATÁNAK



Esztergált felület




Homokfújt felület




Passzivált felület

HIDEGEN MEGMUNKÁLT ÖTVÖZETLEN TISZTA GRADE 4 TITÁN



Callus implantátumok felületi mikrostruktúrája (MPS, SEM 500x)



Callus implantátumok felületi mikrostruktúrája (MPS, SEM 10.000x)


ASTM INTERNATIONAL

*Grade 4 Titanium: T60 commercial pure - Grade 4 T60 commercially pure titanium meets the requirements of ISO 5832-2 and the American Society for Testing and Materials (ASTM F67 3.7065)

*SLA™ (Institue Straumann AG`s trademark)

CSOMAGOLÁS, STERILITÁS

A beültetendő komponensek dupla biztonsági zárása biztosítja, hogy a gamma irradiációnak köszönhető sterilitást legalább öt évre garantáljuk.

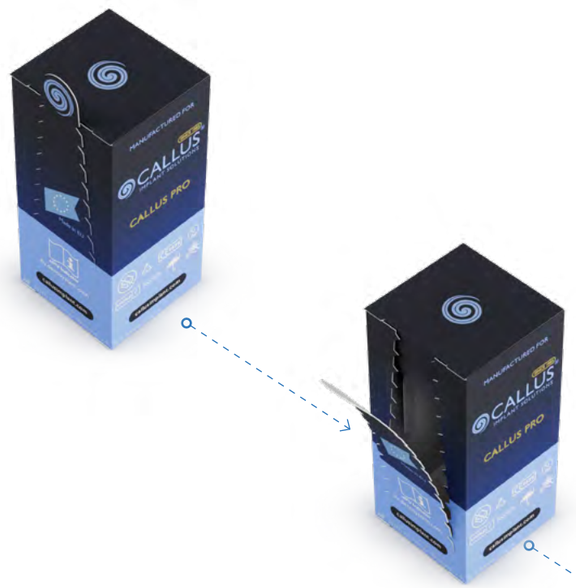



Csomagolás tartalma:

- használati útmutató
- implantátum azonosítására alkalmas matricák

Minden Callus Pro implantátum nyomonkövethetőséget biztosító matricákkal együtt kerül csomagolásra (külső és belső csomagolásán egyaránt). Kérjük a beültetett implantátumok azonosítóit minden esetben őrizze meg!

eIFU
Digitális használati útmutatók

ifu.dentisystem.com

KÜLSŐ CSOMAGOLÁS



BELSŐ CSOMAGOLÁS





ÚJRATERVEZETT,
KETTŐS STERIL CSOMAGOLÁS

INNOVÁCIÓ
KÖRNYEZETBARÁT

FELHASZNÁLHATÓSÁG



Implantátum méretválaszték

CALLUS PRO IMPLANTÁTUMOK

Medical Grade 4 / Pure Titanium

Univerzális “szövetbarát” implantátum, CAD/CAM optimalizált protetikai platformmal. Közvetlenül a behelyezőeszközökkel felvehető csomagolással. Négy különböző átmérő két eltérő protetikai csatlakozással. Gyógyulási csavarral csomagolva.





NARROW

Callus Implantátumok Ø 3.35 mm		
Cikkszám	**Beültetési mélység (mm)**	**Platform Ø (mm)**
CP 1033-100	10.0	3.35
CP 1033-115	11.5	3.35
CP 1033-130	13.0	3.35



Callus Implantátumok Ø 3.8 mm		
Cikkszám	**Beültetési mélység (mm)**	**Platform Ø (mm)**
CP 1038-085	8.5	3.8
CP 1038-100	10.0	3.8
CP 1038-115	11.5	3.8
CP 1038-130	13.0	3.8
CP 1038-160	16.0	3.8



REGULAR

Callus Implantátumok Ø 4.2 mm		
Cikkszám	**Beültetési mélység (mm)**	**Platform Ø (mm)**
CP 1042-070	7.0	4.2
CP 1042-085	8.5	4.2
CP 1042-100	10.0	4.2
CP 1042-115	11.5	4.2
CP 1042-130	13.0	4.2
CP 1042-160	16.0	4.2




Callus Implantátumok Ø 4.8 mm		
Cikkszám	**Beültetési mélység (mm)**	**Platform Ø (mm)**
CP 1048-070	7.0	4.8
CP 1048-085	8.5	4.8
CP 1048-100	10.0	4.8
CP 1048-115	11.5	4.8
CP 1048-130	13.0	4.8



Az implantátumok itt megadott méretei névlegesek. A pontos dimenzióról a behelyezési segédlet kiadványunkban tájékozódhat. Sebészi- és protetikai kompatibilitás kapcsán érdeklődjön orvoslátogatójánál.

Protetika

A Callus Pro implantációs rendszer fő célja, hogy a legtöbb piacon elérhető CAD/CAM rendszerrel integráltan együttműködhessen a kívánt protetikai eredmény eléréséért. Meggyőződésünk, hogy a hosszútávon kiszámítható sikeresség kulcsa a digitális alapokon tervezett és kivitelezett egyedi implantátum protetika. Az akár 100%-os korai implantátum TÚLÉLÉST, mint célt messze nem tekintjük elégségesnek. Az elsődleges kihívás a periimplantális szövetek egészségének biztosítása, aminek fő tényezője, a kielégítő lágyrész tapadást biztosító egyedi emergencia profil kialakítása.

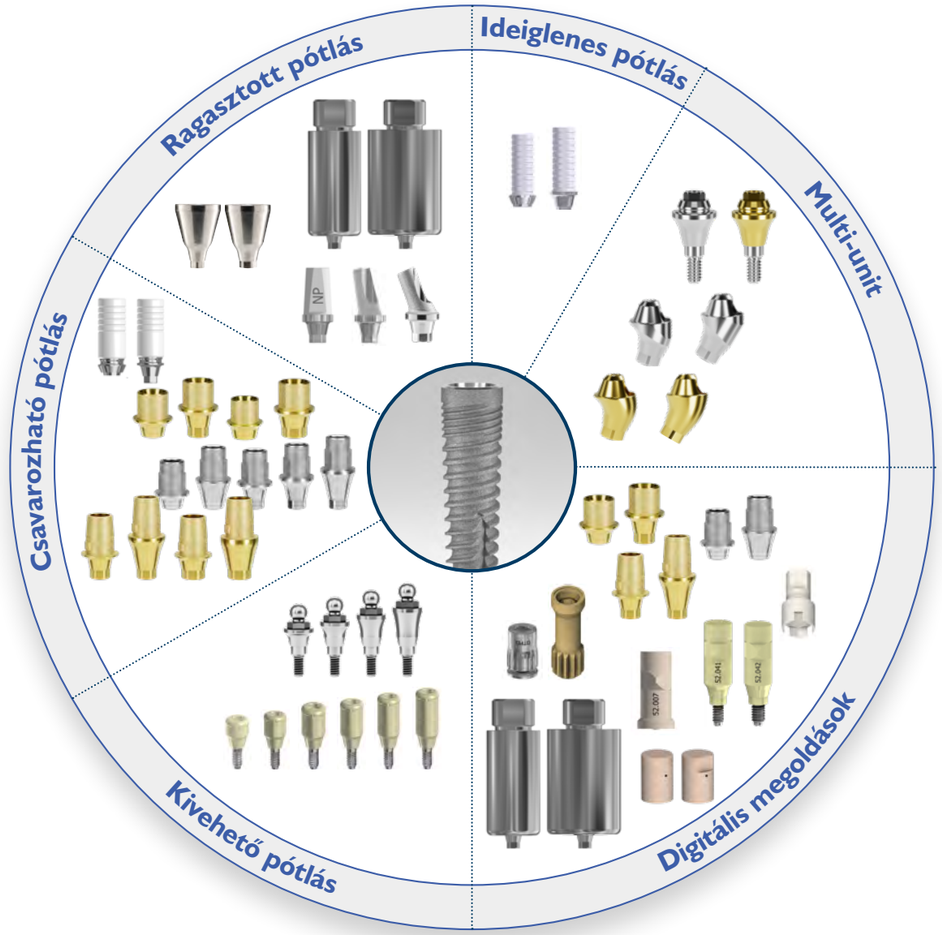


Ragasztott pótlások

EGYENES ÉS SZÖGTÖRÖTT FEJRÉSZEK

Medical Grade 5 ELI Titanium / ASTM F136 Standards

Végleges rögzítőcsavarral csomagolva.



	Egyenes és szögtörött fejrészek						
	Cikkszám	Implantátum Ø (mm)	Magasság (mm)	Ínymagasság (mm)	Ø (mm)	Rögzítőcsavar	Szög
NARROW	**CP 13.041**	3.35; 3.8	7.8	2	4.5	CP 19.027	0
NARROW	**CP 22.041**	3.35; 3.8	7	2	4.5	CP 19.027	15°
NARROW	**CP 13.043**	3.35; 3.8	9.8	4	4.5	CP 19.027	0°
NARROW	**CP 13.045**	3.35; 3.8	11.8	6	4.5	CP 19.027	0°
REGULAR	**CP 13.042**	4.2; 4.8	7.7	2	4.9	CP 19.030	0
REGULAR	**CP 22.042**	4.2; 4.8	7	2	4.9	CP 19.030	15°
REGULAR	**CP 23.042**	4.2; 4.8	7	2	4.9	CP 19.030	25°
REGULAR	**CP 13.044**	4.2; 4.8	9.7	4	4.9	CP 19.030	0°
REGULAR	**CP 13.046**	4.2; 4.8	11.7	6	4.9	CP 19.030	0°



FORDÍTOTT KÚPOS FEJRÉSZEK

univerzálisan, szinte bármilyen ragasztott pótláshoz

Medical Grade 5 ELI Titanium / ASTM F136 Standards

Végleges rögzítőcsavarral csomagolva.




	Fordított kúpos fejrészek			
	Cikkszám	Implantátum Ø (mm)	Platform feletti magasság (mm)	Rögzítőcsavar
N	**CP 13.671**	3.35; 3.8	8.0	CP 19.027
R	**CP 13.672**	4.2; 4.8	8.0	CP 19.030



PRE-MILLED TÖMB

Az innovatív megoldás egyedi emergencia profillal készülő cementezhető felépítmények és egyedi Titán bázisok gyártásához (átmenőcsavaros rögzítéshez). Gyárilag biztosított csatlakozási geometria.



	Pre-milled tömb				
	Cikkszám	Implantátum Ø (mm)	Megmunkálható hossz (mm)	Ti Ø (mm)	Rögzítőcsavar
NARROW	**CP 61.041**	3.35; 3.8	20	10	CP 19.027
NARROW	**CP 62.041**	3.35; 3.8	20	14	CP 19.027
REGULAR	**CP 61.042**	4.2; 4.8	20	10	CP 19.030
REGULAR	**CP 62.042**	4.2; 4.8	20	14	CP 19.030




Pre-milled tömb: a bölcs választás, amire számíthat

A tömb alapanyaga titánium Grade 5 ELI, más néven Grade 23 titán. Maximalizálja a lágyrész tapadási felületet és kompenzálja a készítendő fog alatt protetikailag nem ideális implantátum pozíciót egyedi emergencia profillal. A Pre-milled tömb a legkézenfekvőbb megoldás egy darabból készülő egyedi fejrészek és egyedi ínymagasságú Titán bázisok digitális gyártására. A legelterjedtebb CAD/CAM rendszerekhez elérhető befogórendszerrel.



*A GoDigital jelöléssel ellátott termékek a digitális fejezetben is megtalálhatóak.

Titán bázisok és önthető/beágyazható fejrészek



KRÓM-KOBALT FEJRÉSZEK ALAP ÖNTÉSTECHNOLÓGIÁHOZ

CrCo

Átmenőcsavarral és kiégethető mintázócsővel csomagolva.

	Króm-kobalt fejrészek						
	Cikkszám	Implantátum Ø (mm)	Ínymagasság (mm)	Ø (mm)	Rögzítőcsavar		
NARROW	**CP 30.041**	3.35; 3.8	1.3	4.5	CP 19.027	●	
NARROW	**CP 31.041**	3.35; 3.8	1.3	4.5	CP 19.027	⬢	
REGULAR	**CP 30.042**	4.2; 4.8	1.3	4.8	CP 19.030	●	
REGULAR	**CP 31.042**	4.2; 4.8	1.3	4.8	CP 19.030	⬢	


● no-hex
⬢ hex

TITÁN BÁZISOK

Go Digital

Medical Grade 5 ELI Titanium / ASTM F136 Standards

Homokfúvott felületkiképzés a ragasztási felszín növelésére.
Végleges rögzítőcsavarral csomagolva.

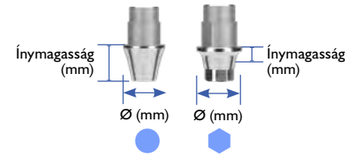

	Titán bázisok						
	Cikkszám	Implantátum Ø (mm)	Ínymagasság (mm)	Ø (mm)	Rögzítőcsavar		
NARROW	**CP 15.041**	3.35; 3.8	1.2	4.5	CP 19.027	●	
NARROW	**CP 15.341**	3.35; 3.8	3.0	4.5	CP 19.027	●	
NARROW	**CP 16.041**	3.35; 3.8	1.2	4.5	CP 19.027	⬢	
NARROW	**CP 16.041/2**	3.35; 3.8	2.0	4.5	CP 19.027	⬢	
NARROW	**CP 16.341**	3.35; 3.8	3.0	4.5	CP 19.027	⬢	
REGULAR	**CP 15.042**	4.2; 4.8	1.2	4.5	CP 19.030	●	
REGULAR	**CP 15.342**	4.2; 4.8	3.0	4.5	CP 19.030	●	
REGULAR	**CP 16.042**	4.2; 4.8	1.2	4.5	CP 19.030	⬢	
REGULAR	**CP 16.042/2**	4.2; 4.8	2.0	4.5	CP 19.030	⬢	
REGULAR	**CP 16.342**	4.2; 4.8	3.0	4.5	CP 19.030	⬢	

● no-hex
⬢ hex

	Kiégethető mintázócső Titán bázishoz					
	Cikkszám	Implantátum Ø (mm)	Magasság (mm)	Info		
N	**CP 32.001-P5**	3.35; 3.8; 4.2; 4.8	11	5db/csomag	●	
N	**CP 33.001-P5**	3.35; 3.8; 4.2; 4.8	11	5db/csomag	⬢	


*A GoDigital jelöléssel ellátott termékek a digitális fejezetben is megtalálhatóak.

SZÖGTÖRÖTT TITÁN BÁZISOK

Go Digital

Medical Grade 5 ELI Titanium / ASTM F136 Standards

Arany színűre anodizált, homokfúvott felületkiképzés a ragasztási felszín növelésére.
Akár 25°-ig döntött csavarcsatorna.
Speciális csavarhúzóval kompatibilis, ami elérhető 20-24-35 mm hosszokban.
Végleges rögzítőcsavarral csomagolva.





Szögtörött Titán bázisok


	Cikkszám	Implantátum Ø (mm)	Ínymagasság (mm)	Ø (mm)	Rögzítőcsavar	
NARROW	**CP 36.041**	3.35; 3.8	1.2	3.5	CP 19.441 TORX	●
NARROW	**CP 37.041**	3.35; 3.8	1.2	3.5	CP 19.441 TORX	⬢
REGULAR	**CP 36.042**	4.2; 4.8	1.2	3.5	CP 19.442 TORX	●
REGULAR	**CP 37.042**	4.2; 4.8	1.2	3.5	CP 19.442 TORX	⬢

● no-hex
⬢ hex




Kiégethető mintázócső szögtörött Titán bázishoz

	Cikkszám	Implantátum Ø (mm)	Magasság (mm)	Szög	Info	
R N	**CP 33.100-P5**	3.35; 3.8; 4.2; 4.8	10.5	0°	5db/csomag	●
R N	**CP 33.101-P5**	3.35; 3.8; 4.2; 4.8	10.5	10°	5db/csomag	●
R N	**CP 33.102-P5**	3.35; 3.8; 4.2; 4.8	10.5	20°	5db/csomag	●



CEREC KOMPATIBILIS TITÁN BÁZIS

CEREC kompatibilis Titán bázis Titán bázis hagyományos és chair-side CAD/CAM rendszerekhez.
Homokfúvott felületkiképzés a ragasztási felszín növelésére.
Végleges rögzítőcsavarral csomagolva.




C-Base

	Cikkszám	Implantátum Ø (mm)	Ínymagasság (mm)	Ø (mm)	Rögzítőcsavar	
NARROW	**CP 59.041**	3.35; 3.8	0.8	4.5	CP 19.027	⬢
NARROW	**CP 59.041/3**	3.35; 3.8	3.0	4.5	CP 19.027	⬢
REGULAR	**CP 59.042**	4.2; 4.8	0.8	4.6	CP 19.030	⬢
REGULAR	**CP 59.042/3**	4.2; 4.8	3.0	4.6	CP 19.030	⬢



*A GoDigital jelöléssel ellátott termékek a digitális fejezetben is megtalálhatóak.

SZÖGTÖRÖTT TITÁN BÁZIS TULAJDONSÁGOK ÉS ELŐNYÖK

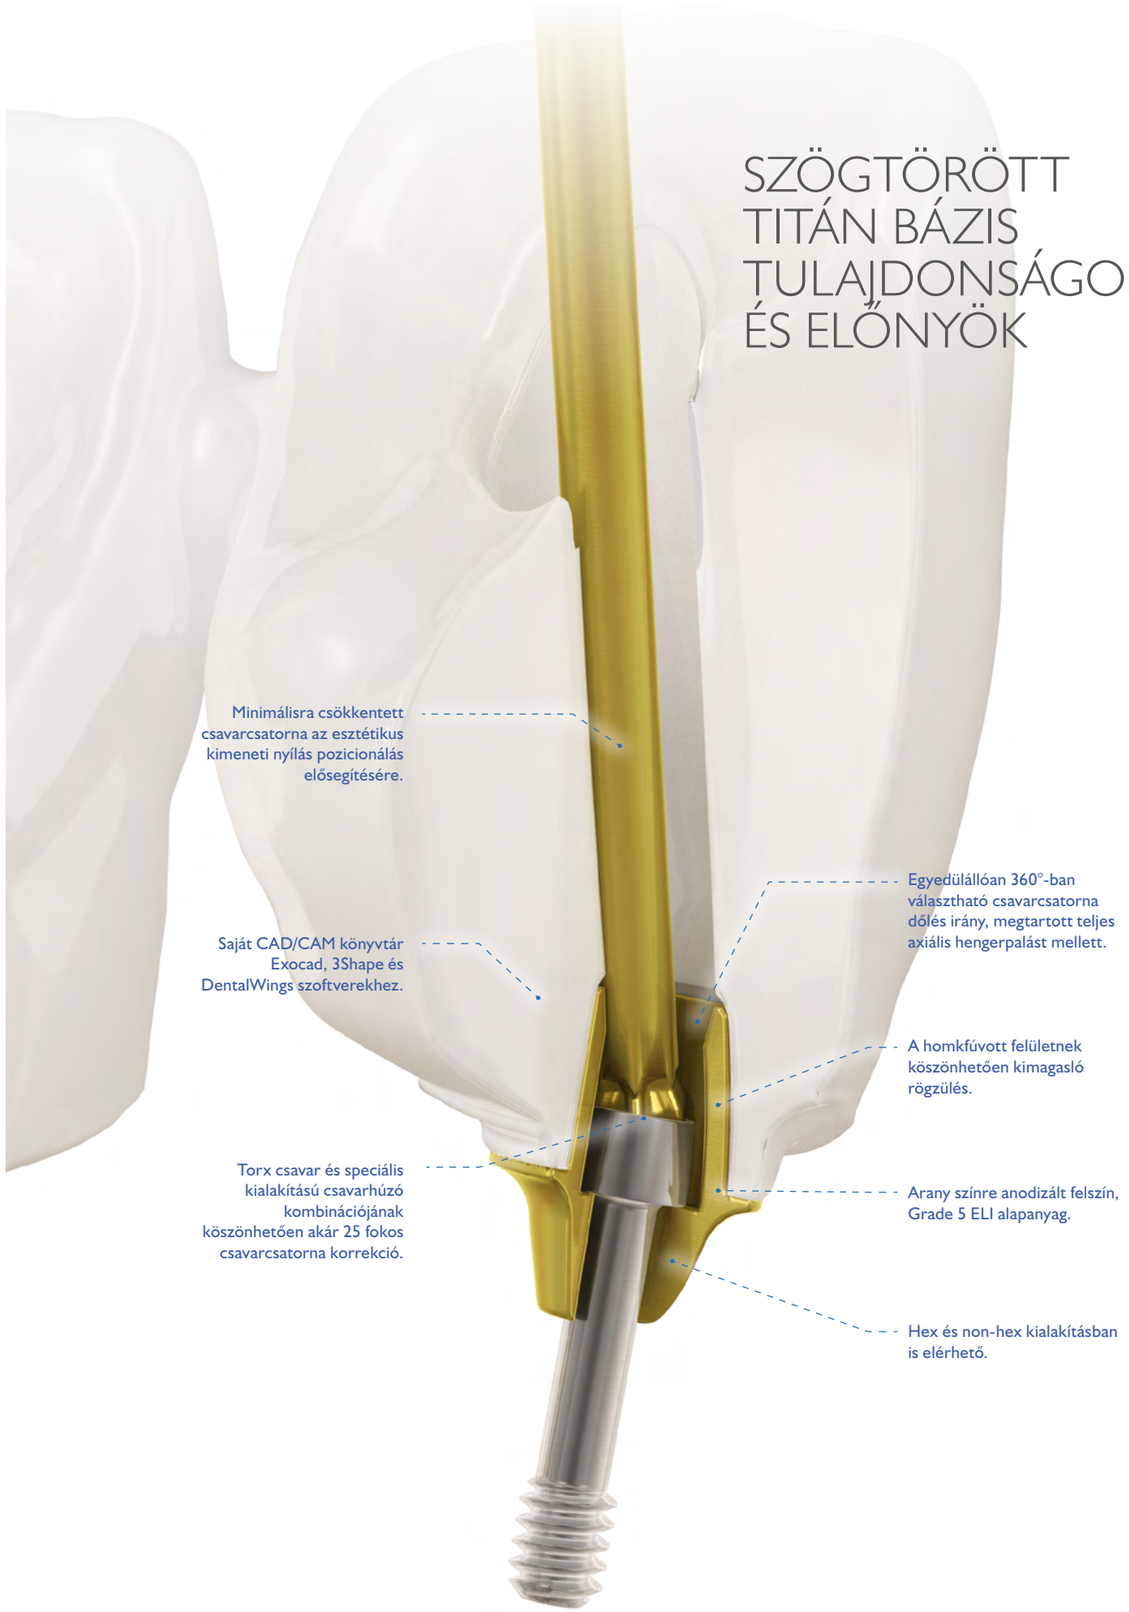


Ideiglenes pótlások

TITÁN IDEIGLENES FELÉPÍTMÉNYEK


Medical Grade 5 ELI Titanium / ASTM F136 Standards

Homokfúvott felületkiképzés a ragasztási felszín növelésére.
Végleges rögzítőcsavarral csomagolva.

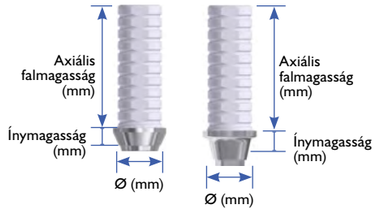

	Titán ideiglenes felépítmények						
	Cikkszám	Implantátum Ø (mm)	Ax. magasság (mm)	Ínymagasság (mm)	Ø (mm)	Csavar	
NARROW	**CP 24.041**	3.35; 3.8	10.5	1.5	4.5	CP 19.027	●
NARROW	**CP 25.041**	3.35; 3.8	10.5	1.5	4.5	CP 19.027	⬢
REGULAR	**CP 24.042**	4.2; 4.8	10.5	1.5	4.8	CP 19.030	●
REGULAR	**CP 25.042**	4.2; 4.8	10.5	1.5	4.8	CP 19.030	⬢

● no-hex
⬢ hex




Kivehető pótlások

GÖMB-RETENCIÓS FELÉPÍTMÉNYEK

Medical Grade 5 ELI Titanium / ASTM F136 Standards

OT-CAP kompatibilis



	Gömb-retenciós felépítmények			
	Cikkszám	Implantátum Ø (mm)	Ínymagasság (mm)	Gömb Ø (mm)
NARROW	**CP 89.039/1**	3.35; 3.8	1.5	2.5
NARROW	**CP 89.039/2**	3.35; 3.8	2.5	2.5
NARROW	**CP 89.039/3**	3.35; 3.8	3.5	2.5
NARROW	**CP 89.039/4**	3.35; 3.8	4.5	2.5
REGULAR	**CP 89.040/1**	4.2; 4.8	1.5	2.5
REGULAR	**CP 89.040/2**	4.2; 4.8	2.5	2.5
REGULAR	**CP 89.040/3**	4.2; 4.8	3.5	2.5
REGULAR	**CP 89.040/4**	4.2; 4.8	4.5	2.5



TARTOZÉKOK

OT-CAP retenciós elemek


OT-CAP	
Cikkszám	
041CAN	Rozsdamentes acél ház (normál méret), 2 db/szett
040CRN	Átlátszó normál méretű betét (szabványos retenció) 1300g, 6 db/szett
040CRNSN	Rózsaszín normál méretű betét (puha retenció) 900g, 6 db/szett
049PCN	Zöld átlátszó normál méretű betét (nagyon rugalmas retenció) 350g, 6 db/szett
040CRNDR8	Akvamarin normál méretű betét (2,25 belső átmérőjű a kopott gömbökhöz) 1300g, 6 db/szett



LOCATOR

Loc-gyűrűs patent rendszer

Egyedi Titán-nitrid (TiN) bevonatának köszönhetően kopásállóbb és kevésbé plakk retentív, mint a bevonat nélküli, vagy hagyományos Titán-nitrid bevonattal ellátott megoldások.
Retenciós elemek külön csomagolva kaphatóak.



DESSLoc® compatible with LOCATOR

	Locator			
	Cikkszám	**Implantátum Ø (mm)**	**Teljes magasság (mm)**	**Ínymagasság (mm)**
NARROW	**CP 88.039/1**	3.35; 3.8	3.0	1.0
	CP 88.039/2	3.35; 3.8	4.0	2.0
	CP 88.039/3	3.35; 3.8	5.0	3.0
	CP 88.039/4	3.35; 3.8	6.0	4.0
	CP 88.039/5	3.35; 3.8	7.0	5.0
	CP 88.039/6	3.35; 3.8	8.0	6.0
REGULAR	**CP 88.040/1**	4.2; 4.8	3.0	1.0
	CP 88.040/2	4.2; 4.8	4.0	2.0
	CP 88.040/3	4.2; 4.8	5.0	3.0
	CP 88.040/4	4.2; 4.8	6.0	4.0
	CP 88.040/5	4.2; 4.8	7.0	5.0
	CP 88.040/6	4.2; 4.8	8.0	6.0



LOCATOR TARTOZÉKOK



	Locator Accessories		
	Cikkszám	**Megnevezés**	**Db.**
NARROW	**2010.101**	Eszközkészlet 3 segédeszközzel: 2010.731, 2010.741, 2010.751. Cserélhető betétek és fogyóanyagok nélkül.	1
	2010.601	Titán feldolgozó készlet: titán mátrixházzal, fekete PEEK szerelőbetéttel, fehér, sárga és zöld retenciós betéttel, valamint szilikon rögzítőgyűrűvel.	2
	2010.611	PEEK feldolgozó készlet: PEEK mátrixházzal, fekete PEEK szerelőbetéttel, fehér, sárga és zöld retenciós betéttel, valamint szilikon rögzítőgyűrűvel.	2
	2010.710	Fehér PEEK retenciós betét, extra könnyű retencióval.	4
	2010.712	Sárga PEEK retenciós betét, közepes retencióval.	4
	2010.713	Zöld PEEK retenciós betét, erős retencióval.	4
	2010.714	Kék PEEK retenciós betét, extra erős retencióval.	4
	2010.715	Fekete PEEK retenciós betét, ultra erős retencióval.	4
	2010.731	Kék eltávolító eszköz szerelőbetéthez, modellanalóg-visszahelyező segéddel.	1
	2010.741	Barna behelyező és eltávolító eszköz retenciós betétekhez.	1
	2010.751	Szürke mátrixház-eltávolító eszköz.	1
	2010.703	Titán mátrixház rögzítési lehetőséggel, PEEK szerelőbetéttel.	4
	2010.701	Titán mátrixház PEEK szerelőbetéttel.	4
	2010.702	PEEK mátrixház PEEK szerelőbetéttel.	4
	2010.725	Fekete PEEK szerelőbetét.	4
	2010.721	Alumínium modellanalóg.	4
	2010.722	Piros PEEK formázó- és rögzítőmátrix.	4
	2010.723	Fehér POM-C feldolgozó távtartó.	4
	2010.724	Szilikon rögzítőgyűrű.	10

























Multi-Unit felépítmények


EGYENES ÉS SZÖGTÖRT MULTI-UNIT FELÉPÍTMÉNYEK

Medical Grade 5 ELI Titanium / ASTM F136 Standards

A termék prémium minőségű Grade 5 ELI titánól készül, az orvostechnikai szabványoknak megfelelően.
A termékválaszték multi-unit csavarokat, lenyomatátviteli elemeket (impression coping), Ti-base elemeket, valamint titán és önthető műanyag felépítményeket tartalmaz.
Az szögtört multi-unit felépítmények rögzítőcsavarral együtt kerülnek szállításra.

A teljes menethosszú kúpos kapcsolat fokozott stabilitást és biztonságos protetikai rögzítést biztosít.

A Callus multi-unit rendszer protetikai sokoldalúságot és egységes protetikai munkafolyamatot biztosít.

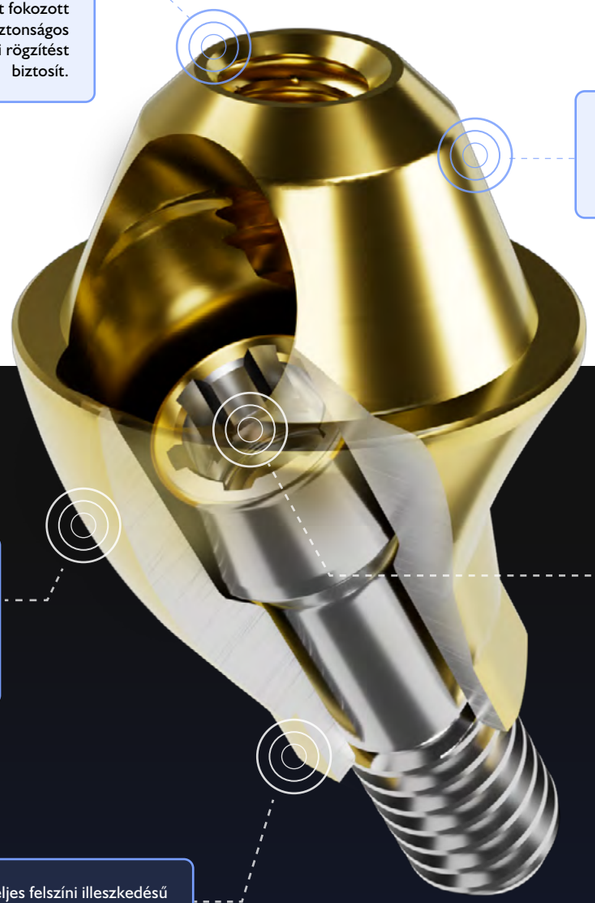

Az anatómiai kialakítás támogatja az íny természetes átmenetét, elősegítve a lágyszövetek természetes illeszkedését a felépítmény körül.

Az egyenes csavarcsatorna-kialakítás egyszerűbb behelyezést tesz lehetővé, és akár 35 Ncm meghúzási nyomaték alkalmazását biztosítja, csökkentve a csavarlazulás kockázatát és javítva a hosszú távú protetikai stabilitást.

A teljes felszíni illeszkedésű csatlakozás fokozott stabilitást és megbízható protetikai megtámasztást biztosít.

MULTI-UNIT

MULTI-UNIT ABUTMENTS


Titán-nitrid (TiN) bevonat

A Multi-Unit felépítmény nagy teljesítményű titán-nitrid (TiN) bevonattal is elérhető, amelyet a tartósság, az esztétika és a biológiai teljesítmény javítására fejlesztettek ki a magas klinikai elvárásoknak megfelelően.

A TiN felület előnyei:

- Kiemelkedő kopásállóság a hosszú távú protetikai stabilitás érdekében
- Csökkentett felületi súrlódás és fokozott felületi keménység
- Kémiailag inert és biokompatibilis felületi tulajdonságok
- Fokozott korrózió- és mechanikai kopásállóság
- Aranyszínű esztétikus megjelenés a lágyszövetek jobb maszkolása érdekében
- Autoklávozható és ismételt klinikai használatra alkalmas

A bevonattechnológia hozzájárul a protetikai kapcsolat megbízhatóságához és hosszú élettartamához, miközben támogatja a modern implantológiában elvárt szigorú klinikai és esztétikai követelményeket.

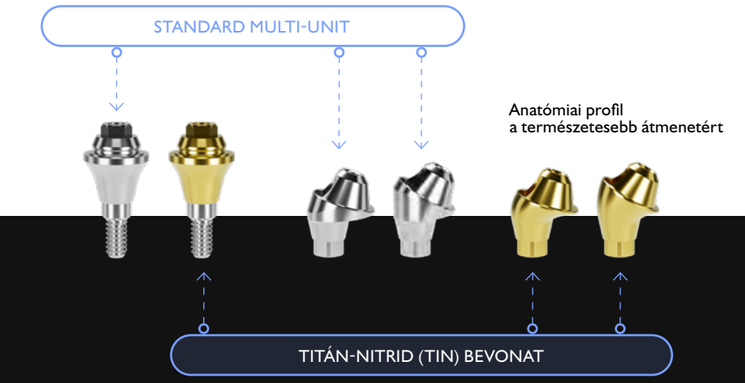


A csomagolás része a csavar és a behejező (CP MUI).









Kevesebb gyulladás
Alacsonyabb plakkretenció
Magasabb korrózióállóság
Könnyebb tisztíthatóság
A titán-oxidnál hatszor keményebb felület









Multi-Unit fejrészek


no-hex
hex

Cikkszám	Implantátum Ø (mm)	Magasság (mm)	Ínymagas-ság (mm)	GH1 - Ínymagasság 1 (mm)	GH2 - Ínymagas-ság 2 (mm)	Ø (mm)	Szög	
NARROW								
CP 40.007/1	3.35; 3.8	2.2	1.5	-	-	4.8	0	●
CP 40.007/2	3.35; 3.8	2.2	2.5	-	-	4.8	0	●
CP 40.007/3	3.35; 3.8	2.2	3.5	-	-	4.8	0	●
CP 40.007/1 STA	3.35; 3.8	2.2	1.5	-	-	4.8	0	●
CP 40.007/2 STA	3.35; 3.8	2.2	2.5	-	-	4.8	0	●
CP 40.007/3 STA	3.35; 3.8	2.2	3.5	-	-	4.8	0	●
CP 41.707/2	3.35; 3.8	2.2	-	1.1	2.5	4.8	17	⬢
CP 41.707/3	3.35; 3.8	2.2	-	2.1	3.5	4.8	17	⬢
CP 43.007/3	3.35; 3.8	2.2	-	1.1	3.5	4.8	30	⬢
CP 43.007/4	3.35; 3.8	2.2	-	2.1	4.5	4.8	30	⬢
CP 41.707/2 STA	3.35; 3.8	2.2	-	1.1	2.5	4.8	17	⬢
CP 41.707/3 STA	3.35; 3.8	2.2	-	2.1	3.5	4.8	17	⬢
CP 43.007/3 STA	3.35; 3.8	2.2	-	1.1	3.5	4.8	30	⬢
CP 43.007/4 STA	3.35; 3.8	2.2	-	2.1	4.5	4.8	30	⬢
CP 19.507	3.35; 3.8	A csomagolás része a csavar és a behejező (CP MUI)						









Multi-Unit Abutments

Cikkszám	Implantátum Ø (mm)	Magasság (mm)	Ínymagas-ság (mm)	GH1 - Ínymagas-ság 1 (mm)	GH2 - Ínymagas-ság 2 (mm)	Ø (mm)	Szög	
REGULAR								
CP 40.008/1	4.2; 4.8	2.2	1.5	-	-	4.8	0	●
CP 40.008/2	4.2; 4.8	2.2	2.5	-	-	4.8	0	●
CP 40.008/3	4.2; 4.8	2.2	3.5	-	-	4.8	0	●
CP 40.008/4	4.2; 4.8	2.2	4.5	-	-	4.8	0	●
CP 40.008/1 STA	4.2; 4.8	2.2	1.5	-	-	4.8	0	●
CP 40.008/2 STA	4.2; 4.8	2.2	2.5	-	-	4.8	0	●
CP 40.008/3 STA	4.2; 4.8	2.2	3.5	-	-	4.8	0	●
CP 40.008/4 STA	4.2; 4.8	2.2	4.5	-	-	4.8	0	●
CP 41.708/2	4.2; 4.8	2.2	-	1.1	2.5	4.8	17	⬢
CP 41.708/3	4.2; 4.8	2.2	-	2.1	3.5	4.8	17	⬢
CP 43.008/3	4.2; 4.8	2.2	-	1.1	3.5	4.8	30	⬢
CP 43.008/4	4.2; 4.8	2.2	-	2.1	4.5	4.8	30	⬢
CP 41.708/2 STA	4.2; 4.8	2.2	-	1.1	2.5	4.8	17	⬢
CP 41.708/3 STA	4.2; 4.8	2.2	-	2.1	3.5	4.8	17	⬢
CP 43.008/3 STA	4.2; 4.8	2.2	-	1.1	3.5	4.8	30	⬢
CP 43.008/4 STA	4.2; 4.8	2.2	-	2.1	4.5	4.8	30	⬢
CP 19.508	4.2; 4.8	A csomagolás része a csavar és a behejező (CP MUI)						



MULTI-UNIT KIEGÉSZÍTŐK

Multi-Unit Accessories

	Cikkszám	Implantátum Ø (mm)	Megnevezés	Teljes hossz (mm)	Ínymagasság (mm)	Rögzítő csavar	Info		
R N	**CP 14.007**	3.35; 3.8; 4.2; 4.8	Multi-Unit laborimplantátum	-	-	-	-		
R N	**CP 17.007**	3.35; 3.8; 4.2; 4.8	Multi-Unit lenyomatvételi műcsonk	12	-	Saját rögzítőcsavarjaival csomagolva	Nyitott- és zárt kanalas technikához		
R N	**CP 17.807**	3.35; 3.8; 4.2; 4.8	Multi-Unit lenyomatvételi műcsonk	8	-	-	Kizárólag zárt kanalas technikához		
R N	**CP 24.007**	3.35; 3.8; 4.2; 4.8	Multi-Unit ideiglenes fejrész	12		CP 19.006	-	●	
R N	**CP 25.707TB**	3.35; 3.8; 4.2; 4.8	Multi-Unit ideiglenes fejrész PeekTorx	12	-	CP 19.306	-	●	
R N	**CP 20.100**	3.35; 3.8; 4.2; 4.8	Multi-Unit gyógyulási fejrész	4.15		CP 19.006	-	●	
R N	**CP 28.007**	3.35; 3.8; 4.2; 4.8	Multi-Unit kiégethető mintázócső	11.5		CP 19.006		●	
R N	**CP 88.007**	3.35; 3.8; 4.2; 4.8	Multi-Unit DESSLoc®	4.3		-	-		
R N	**CP 52.007**	3.35; 3.8; 4.2; 4.8	Multi-Unit scan body	7.5		Saját rögzítő-csavarjával csomagolva	Intraorális és asztali szkenneléshez		 Go Digital
R N	**CP 15.007**	3.35; 3.8; 4.2; 4.8	Multi-Unit Titán bázis	6	0.3	CP 19.006	-	●	 Go Digital
R N	**CP 32.007-P5**	3.35; 3.8; 4.2; 4.8	Multi-Unit kiégethető mintázócső Titán bázishoz			-	5db/csomag	●	
R N	**CP 30.007**	3.35; 3.8; 4.2; 4.8	Multi-Unit CrCo fejrész	12		CP 19.006	-	●	
R N	**CP 36.007**	3.35; 3.8; 4.2; 4.8	Multi-Unit szögtörött Titán bázis	5		CP 19.306	Torx csavarhúzóhoz	●	 Go Digital

*A GoDigital jelöléssel ellátott termékek a digitális fejezetben is megtalálhatóak.



Multi-Unit kézi behelyező eszköz

Cikkszám	Implantátum Ø (mm)	Info
CP MUI	3.35; 3.8; 4.2; 4.8	Multi-Unit kézi behelyező eszköz (szögtörött Multi-Unit fejrészekhez)

MULTI-UNIT ABUTMENTS


MULTI-UNIT

EGYENES ÉS SZÖGTÖRT MULTI-UNIT FELÉPÍTMÉNYEK



Digitális Protetikai kiegészítők

TITÁN BÁZISOK



Medical Grade 5 ELI Titanium / ASTM F136 Standards

Homokfúvott felületkiképzés a ragasztási felszín növelésére.
Végleges rögzítőcsavarral csomagolva.

	Titán bázisok						
	Cikkszám	Implantátum Ø (mm)	Ínymagasság (mm)	Ø (mm)	Rögzítőcsavar		
NARROW	**CP 15.041**	3.35; 3.8	1.2	4.5	CP 19.027	●	
	CP 15.341	3.35; 3.8	3.0	4.5	CP 19.027	●	
	CP 16.041	3.35; 3.8	1.2	4.5	CP 19.027	⬢	
	CP 16.041/2	3.35; 3.8	2.0	4.5	CP 19.027	⬢	
	CP 16.341	3.35; 3.8	3.0	4.5	CP 19.027	⬢	
REGULAR	**CP 15.042**	4.2; 4.8	1.2	4.5	CP 19.030	●	
	CP 15.342	4.2; 4.8	3.0	4.5	CP 19.030	●	
	CP 16.042	4.2; 4.8	1.2	4.5	CP 19.030	⬢	
	CP 16.042/2	4.2; 4.8	2.0	4.5	CP 19.030	⬢	
	CP 16.342	4.2; 4.8	3.0	4.5	CP 19.030	⬢	

● no-hex
⬢ hex


	Kiégethető mintázócső Titán bázishoz				
	Cikkszám	Implantátum Ø (mm)	Magasság (mm)	Info	
R N	**CP 32.001-P5**	3.35; 3.8; 4.2; 4.8	11	Pack of 5	●
	CP 33.001-P5	3.35; 3.8; 4.2; 4.8	11	Pack of 5	⬢

SZÖGTÖRÖTT TITÁN BÁZISOK

Go Digital

Medical Grade 5 ELI Titanium / ASTM F136 Standards

Arany színűre anodizált, homokfúvott felületkiképzés a ragasztási felszín növelésére.
Akár 25°-ig döntött csavarcsatorna.
Speciális csavarhúzóval kompatibilis, ami elérhető 20-24-35 mm hosszokban.
Végleges rögzítőcsavarral csomagolva.

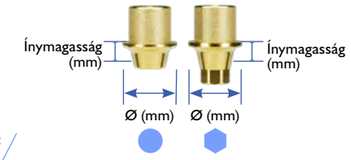


Döntött csavarc-satorna

	Szögtörött Titán bázisok						
	Cikkszám	Implantátum Ø (mm)	Ínymagasság (mm)	Ø (mm)	Rögzítőcsavar		
NARROW	**CP 36.041**	3.35; 3.8	1.2	3.5	CP 19.441 TORX	●	
	CP 37.041	3.35; 3.8	1.2	3.5	CP 19.441 TORX	⬢	
REGULAR	**CP 36.042**	4.2; 4.8	1.2	3.5	CP 19.442 TORX	●	
	CP 37.042	4.2; 4.8	1.2	3.5	CP 19.442 TORX	⬢	


● no-hex
⬢ hex

	Kiégethető mintázócső szögtörött Titán bázishoz					
	Cikkszám	Implantátum Ø (mm)	Magasság (mm)	Szög	Info	
R N	**CP 33.100-P5**	3.35; 3.8; 4.2; 4.8	10.5	0°	5db/csomag	●
	CP 33.101-P5	3.35; 3.8; 4.2; 4.8	10.5	10°	5db/csomag	●
	CP 33.102-P5	3.35; 3.8; 4.2; 4.8	10.5	20°	5db/csomag	●



CEREC KOMPATIBILIS TITÁN BÁZIS

CEREC kompatibilis Titán bázis Titán bázis hagyományos és chair-side CAD/CAM rendszerekhez.
Homokfúvott felületkiképzés a ragasztási felszín növelésére.
Végleges rögzítőcsavarral csomagolva.



	C-Base					
	Cikkszám	Implantátum Ø (mm)	Ínymagasság (mm)	Ø (mm)	Rögzítőcsavar	
NARROW	**CP 59.041**	3.35; 3.8	0.8	4.5	CP 19.027	⬢
	CP 59.041/3	3.35; 3.8	3.0	4.5	CP 19.027	⬢
REGULAR	**CP 59.042**	4.2; 4.8	0.8	4.6	CP 19.030	⬢
	CP 59.042/3	4.2; 4.8	3.0	4.6	CP 19.030	⬢



*A GoDigital jelöléssel ellátott termékek a digitális fejezetben is megtalálhatóak.

LABOR ÉS INTRAORÁLIS SCAN BODY-K

Scan body-nak megfelelő indikáció specifikus könyvtárak elérhetőek Exocad, 3Shape és DentalWings rendszerekhez. Intraorális scan body (laborban is ajánlott) speciális rögzítőcsavarral csomagolva. Mindössze 4 mm átmérő intraorális felhasználáshoz. Érdeklődjön orvoslátogatójánál.

Labor és intraorális scan body-k és kiegészítők

	Cikkszám	Implantátum Ø (mm)	Megnevezés	Teljes magasság (mm)	Rögzítőcsavar	Info
N	**CP 52.041**	3.35; 3.8	Scan body	10	-	-
R	**CP 52.042**	4.2; 4.8	Scan body	10	-	-
REGULAR NARROW	**EXTISA**	-	Scan body hosszabító	-	-	DESS könyvtár szükséges a továbbtervezéshez
REGULAR NARROW	**CP 52.007**	3.35; 3.8; 4.2; 4.8	Multi-Unit scan body	7.5	Saját rögzítőcsavar-jával csomagolva	Intraorális és asztali szkenneléshez
REGULAR NARROW	**DTPEI**	3.35; 3.8; 4.2; 4.8	Kézi csavarhúzó intraorális scan body-hoz	-	-	-
REGULAR NARROW	**DTPEIPEEK-P2**	3.35; 3.8; 4.2; 4.8	Kézi műszer intraorális scan body-hoz	-	-	-



PRE-MILLED TÖMB

Az innovatív megoldás egyedi emergencia profillal készülő cementezhető felépítmények és egyedi Titán bázisok gyártásához (átmenőcsavaros rögzítéshez). Gyárilag biztosított csatlakozási geometria.



Pre-milled tömb

	Cikkszám	Implantátum Ø (mm)	Megmunkálható hossz (mm)	Ti Ø (mm)	Rögzítőcsavar
NARROW	**CP 61.041**	3.35; 3.8	20	10	CP 19.027
NARROW	**CP 62.041**	3.35; 3.8	20	14	CP 19.027
REGULAR	**CP 61.042**	4.2; 4.8	20	10	CP 19.030
REGULAR	**CP 62.042**	4.2; 4.8	20	14	CP 19.030



DIGITÁLIS LABORIMPLANTÁTUMOK

Színre anodizált titán ötvözetből készült analógok rendkívül pontosak, jól illeszkednek és strapabíróak. Ingyenesen elérhetőek a digitális analóg könyvtár fájlok.
Hex 1,27 mm rögzítőcsavarral csomagolva. A rögzítőcsavar külön is megvásárolható.

Digitális laborimplantátumok

	Cikkszám	Implantátum Ø (mm)	Rögzítőcsavar
N	**CP 14.041/D**	3.35; 3.8	CP 19.712
R	**CP 14.042/D**	4.2; 4.8	CP 19.712



Laborimplantátumok / Rögzítőcsavarok

LABORIMPLANTÁTUMOK (ANALÓG)

Surgical Stainless Steel AISI-303

Színre anodizált titán ötvözetből készült analógok rendkívül pontosak, jól illeszkednek és strapabíróak. Ingyenesen elérhetőek a digitális analóg könyvtár fájlok.

Laborimplantátumok

	Cikkszám	Implantátum Ø (mm)	Rögzítőcsavar
N	**CP 14.041**	3.35; 3.8	
N	**CP 14.041/D**	3.35; 3.8	CP 19.712
R	**CP 14.042**	4.2; 4.8	
R	**CP 14.042/D**	4.2; 4.8	CP 19.712



RÖGZÍTŐCSAVAROK

Végleges nyomaték 35 Ncm

Rögzítőcsavarok

	Cikkszám	Implantátum Ø (mm)	Csavar Ø (mm)	Megnevezés
NARROW	**CP 19.027**	3.35; 3.8	M1.6	Rögzítőcsavar
NARROW	**CP 19.227**	3.35; 3.8		DLC bevonatú rögzítőcsavar
NARROW	**CP 19.441**	3.35; 3.8		Titán bázis rögzítőcsavar TORX BALL csavarhúzóhoz
NARROW	**CP 19.507**	3.35; 3.8		Multi-Unit rögzítőcsavar szögtörött fejrészekhez
REGULAR	**CP 19.030**	4.2; 4.8	M2.0	Rögzítőcsavar
REGULAR	**CP 19.230**	4.2; 4.8		DLC bevonatú rögzítőcsavar
REGULAR	**CP 19.442**	4.2; 4.8		Titán bázis rögzítőcsavar TORX BALL csavarhúzóhoz
REGULAR	**CP 19.508**	4.2; 4.8		Multi-Unit rögzítőcsavar szögtörött fejrészekhez



Végleges nyomaték 15 Ncm

Rögzítőcsavarok Multi-Unit kiegészítőkhöz

	Cikkszám	Implantátum Ø (mm)	Megnevezés
R N	**CP 19.006**	3.35; 3.8; 4.2; 4.8	Multi-Unit rögzítőcsavar
R N	**CP 19.206**	3.35; 3.8; 4.2; 4.8	Multi-Unit DLC bevonatú rögzítőcsavar
R N	**CP 19.306**	3.35; 3.8; 4.2; 4.8	Multi-Unit szögtörött Titán bázis rögzítőcsavar TORX BALL csavarhúzóhoz



Rögzítőcsavarok lenyomatvételi műcsonkokhoz, nyitott kanalas technikához

	Cikkszám	Implantátum Ø (mm)
N	**CP TONS**	3.35; 3.8
R	**CP TORS**	4.2; 4.8



Csavarok digitális laborimplantátumokhoz

	Cikkszám	Implantátum Ø (mm)	Info
R N	**CP 19.712-P5**	3.35; 3.8; 4.2; 4.8	Hex 1.27 mm rögzítőcsavar laborimplantátumokhoz. 5db/csomag



*A GoDigital jelöléssel ellátott termékek a digitális fejezetben is megtalálhatóak.

Ínyformázók és lenyomatvételi műcsonkok

ÍNYFORMÁZÓK

Medical Grade 4 ELI Titanium / ASTM F136 Standards

Narrow és Regular platformhoz egyaránt vékony (SLIM), normál (REGULAR) és széles (WIDE) ínyformázók rendelhetőek. V1 emergencia vékony lágyrészhez, illetve alacsony Titán bázisokhoz; V2 emergencia vastag lágyrészhez, illetve magas Titán bázisokhoz. Egyedi emergenciaprofilhoz egyedileg választható forma.

V1: Vékony lágyrészhez, alacsony Titán bázisokhoz
V2: Vastag lágyrészhez, magas Titán bázisokhoz



	Ínyformázók					
NARROW	Cikkszám	CP NN1L5	CP NR1L3	CP NR1L5	CP NR2L5	CP NR2L7	CP NW1L5
	Implantátum Ø (mm)	3.35; 3.8	3.35; 3.8	3.35; 3.8	3.35; 3.8	3.35; 3.8	3.35; 3.8
	Platform	Vékony	NORMÁL	NORMÁL	NORMÁL	NORMÁL	Széles
	Magasság(mm)	5	3	5	5	7	5
	Ø (mm)	3.8	4.9	4.9	4.9	4.9	5.8
		V1	V1	V1	V2	V2	V1



	Ínyformázók					
REGULAR	Cikkszám	CP RN1L5	CP RR1L3	CP RR1L5	CP RR2L5	CP RR2L7	CP RW1L5
	Implantátum Ø (mm)	4.2; 4.8	4.2; 4.8	4.2; 4.8	4.2; 4.8	4.2; 4.8	4.2; 4.8
	Platform	VÉKONY	NORMÁL	NORMÁL	NORMÁL	NORMÁL	SZÉLES
	Magasság(mm)	5	3	5	5	7	5
	Ø (mm)	4.9	5.8	5.8	5.8	5.8	6.6
		V1	V1	V1	V2	V2	V1

LENYOMATVÉTELI MŰCSONKOK

Rögzítőcsavarral csomagolva



	Zárt kanalas technikához				
NARROW	Cikkszám	CP TNN1	CP TNR1	CP TNR2	CP TNW1
	Implantátum Ø (mm)	3.35; 3.8	3.35; 3.8	3.35; 3.8	3.35; 3.8
	Rögzítőcsavar	CP 19.027	CP 19.027	CP 19.027	CP 19.027
	Magasság(mm)	11.5	11.5	11.5	11.5
	Ø (mm)	3.8	4.9	4.9	5.8



	Zárt kanalas technikához				
REGULAR	Cikkszám	CP TRN1	CP TRR1	CP TRR2	CP TRW1
	Implantátum Ø (mm)	4.2; 4.8	4.2; 4.8	4.2; 4.8	4.2; 4.8
	Rögzítőcsavar	CP 19.030	CP 19.030	CP 19.030	CP 19.030
	Magasság(mm)	11.5	11.5	11.5	11.5
	Ø (mm)	4.9	5.8	5.8	6.6



	Nyitott kanalas technikához				
NARROW	Cikkszám	CP TONN1	CP TONR1	CP TONR2	CPTONW1
	Implantátum Ø (mm)	3.35; 3.8	3.35; 3.8	3.35; 3.8	3.35; 3.8
	Rögzítőcsavar	CP TONS	CP TONS	CP TONS	CP TONS
	Magasság(mm)	10	10	10	10
	Ø (mm)	3.8	4.9	4.9	5.8



	Nyitott kanalas technikához				
REGULAR	Cikkszám	CP TORN1	CP TORR1	CP TORR2	CPTORW1
	Implantátum Ø (mm)	4.2; 4.8	4.2; 4.8	4.2; 4.8	4.2; 4.8
	Rögzítőcsavar	CP TORS	CP TORS	CP TORS	CP TORS
	Magasság(mm)	10	10	10	10
	Ø (mm)	4.9	5.8	5.8	6.6

Átvivősapkás lenyomatvételi műcsonk

Zárt kanalas technikához

Implantátum platformnak megfelelően közepes szélességben elérhetőek, eltérő ínymagassággal és emergencia profillal. (Ínyformázókkal egyező kialakítású emergenciák). Átvivősapkával csomagolva. Sapka külön is elérhető.

V1: Vékony lágyrészhez, alacsony Titán bázisokhoz
V2: Vastag lágyrészhez, magas Titán bázisokhoz



NARROW


Átvivősapkás lenyomatvételi műcsonk (sapkával együtt csomagolva)				Átvívő sapka
Cikkszám	**CP TCNR1S**	**CP TCNR1N**	**CP TCNR2N**	**CP 34724**
Implantátum Ø (mm)	3.35; 3.8	3.35; 3.8	3.35; 3.8	Egyszer használható!
Rögzítőcsavar	CP 19.027	CP 19.027	CP 19.027	
Magasság (mm)	9.5	11.5	11.5	8.0
Ø (mm)	4.9	4.9	4.9	Sapka külön is elérhető (3db/csomag)
	RÖVID	NORMÁL	NORMÁL	
	V1	V1	V2	




REGULAR

Átvivősapkás lenyomati komponens (sapkával együtt)				Átvívő sapka
Cikkszám	**CP TCRR1S**	**CP TCRR1N**	**CP TCRR2N**	**CP 34724**
Implantátum Ø (mm)	4.2; 4.8	4.2; 4.8	4.2; 4.8	Egyszer használható!
Rögzítőcsavar	CP 19.030	CP 19.030	CP 19.030	
Magasság (mm)	9.5	11.5	11.5	8.0
Ø (mm)	5.8	5.8	5.8	Sapka külön is elérhető (3db/csomag)
	RÖVID	NORMÁL	NORMÁL	
	V1	V1	V2	

Az alábbi táblázat szemlélteti az egyező/összetartozó emergenciájú komponenseket.

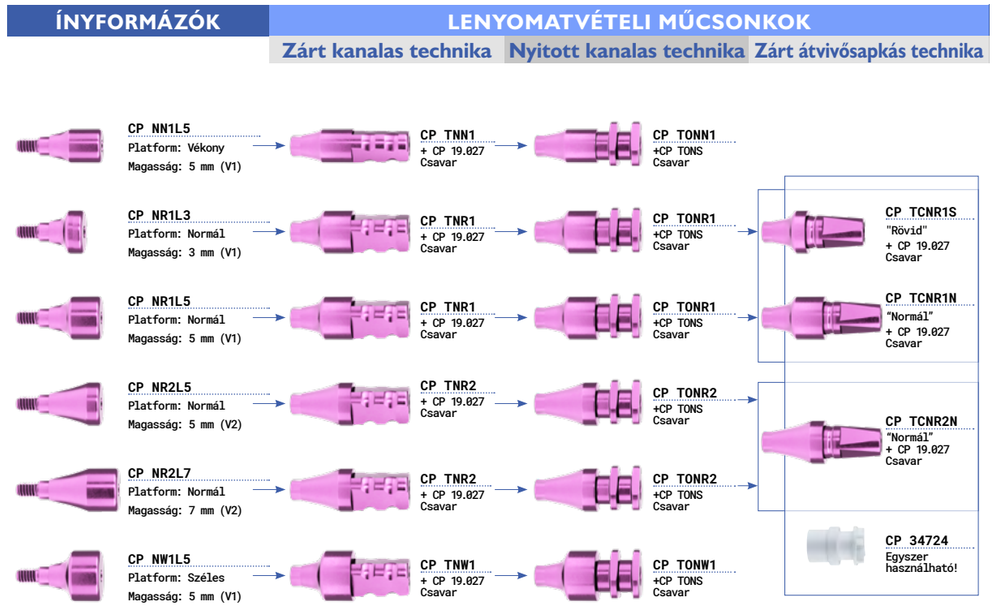

V1: Vékony lágyrészhez. alacsony titán bázisokhoz
V2: Vastag lágyrészhez. magas titán bázisokhoz

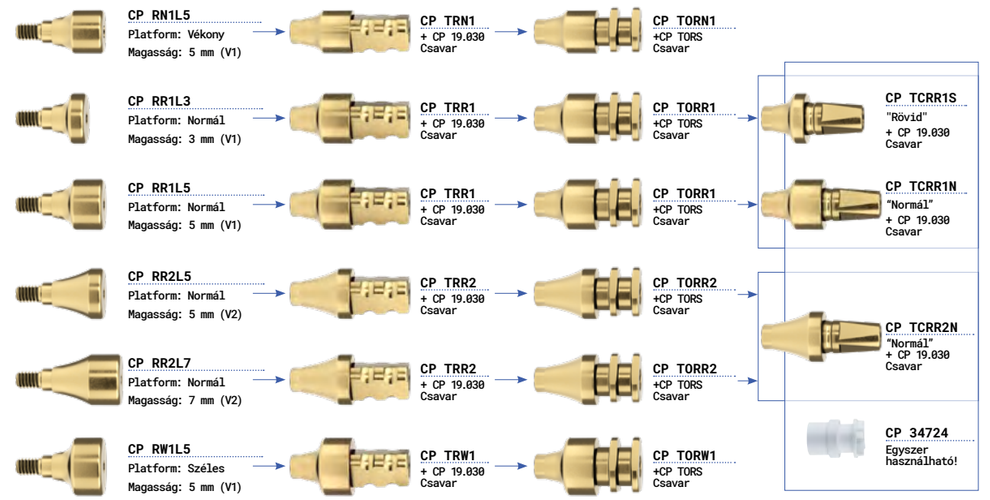

Sebészeti tálca

SEBÉSZETI MŰSZEREK

A sebészeti műszerek Németországban készülnek a legmagasabb minőségi előírások szerint.



Jelölő- és pilot fúrók

	Jelölő- és pilot fúrók			
	Cikkszám	Implantátum Ø (mm)	Megnevezés	Teljes hossz (mm)
R N	**8000-066**	3.35; 3.8; 4.2; 4.8	Gömbfúró	
R N	**8000-067**	3.35; 3.8; 4.2; 4.8	Jelölőfúró	
R N	**CP 2mmS**	3.35; 3.8; 4.2; 4.8	Pilot fúró	19
R N	**CP 2mmL**	3.35; 3.8; 4.2; 4.8	Pilot fúró	22



Pilot fúrók


Irányt meghatározó furat készítéshez szabad kézzel, vagy pilot guide navigációval.
A hosszjelölések a magfúrótól eltérően a teljes valódi preparációs mélységet jelentik.
DLC bevonat a tartós és sima vágóteljesítményért és jó mélység leolvasásért.



Magfúrók

DLC bevonat a tartós és sima vágóteljesítményért és jó mélység leolvasásért. Színkódolt átmérő.
Lépcsős-párhuzamos kialakítás a pilot irányának megtartásáért (Guide ready).
A hosszjelölés a beültetendő implantátum névleges hosszának megfelelő, nem a valós preparációs mélységet jelenti. A valós preparációs mélységről feltétlenül tájékozódjon a sebészeti útmutatóban, illetve használja a sebészeti tálca mérőskáláját!

	Magfúrók			
	Cikkszám	Implantátum Ø (mm)	Megnevezés	Színkód
R N	**CD-1**	3.35; 3.8; 4.2; 4.8	1 Magfúró 2.0/2.3	Színkód nélküli
R N	**CD-2**	3.35	2 Magfúró 2.3/2.8	Szürke
R N	**CD-3**	3.8	3 Magfúró 2.8/3.3	Lila
R	**CD-4**	4.2	4 Magfúró 3.3/3.7	Sárga
R	**CD-5**	4.8	5 Magfúró 3.7/4.3	Kék

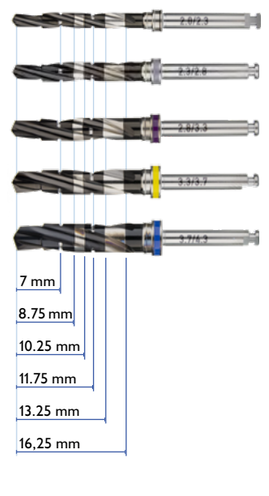

Kortikális fúrók

A cervikális csont kompressziómentesítése céljából ajánlott közepes és kemény csont esetén.

	Kortikális fúrók			
	Cikkszám	Implantátum Ø (mm)	Megnevezés	Színkód
N	**C3.3**	3.35	Kortikális fúró	Szürke
N	**C3.75**	3.8	Kortikális fúró	Lila
R	**C4.2**	4.2	Kortikális fúró	Sárga
R	**C4.8**	4.8	Kortikális fúró	Kék



Implantátum testrész behajtókulcsok

PEEK gyűrűvel az implantátum stabil felvételéért.




	Implantátum testrész behajtókulcsok				
	Cikkszám	Implantátum Ø (mm)	Megnevezés	Teljes hossz (mm)	Info
N	**ID-NS**	3.35; 3.8	Implantátum testrész behajtókulcs	29	Rövid
N	**ID-NL**	3.35; 3.8	Implantátum testrész behajtókulcs	35	Hosszú
R	**ID-RS**	4.2; 4.8	Implantátum testrész behajtókulcs	29	Rövid
R	**ID-RL**	4.2; 4.8	Implantátum testrész behajtókulcs	35	Hosszú



Kiegészítők

Az opcionális termékeket a sebészeti tálca nem tartalmazza, azok külön rendelhetőek.

	Kiegészítők			
	Cikkszám	Implantátum Ø (mm)	Megnevezés	
R N	**8000-057**	3.35; 3.8; 4.2; 4.8	Fúrószár hosszabbító	
R N	**DT24U**	3.35; 3.8; 4.2; 4.8	Közepes csavarhúzó	
R N	**CP MSD**	3.35; 3.8; 4.2; 4.8	Kézi csavarhúzó (opcionális)	
R N	**PP**	3.35; 3.8; 4.2; 4.8	Párhuzamosságot ellenőrző csap	
R N	**GSLEEVE**	3.35; 3.8; 4.2; 4.8	Pilot Guide persely - navigált pilot fúráshoz (opcionális)	

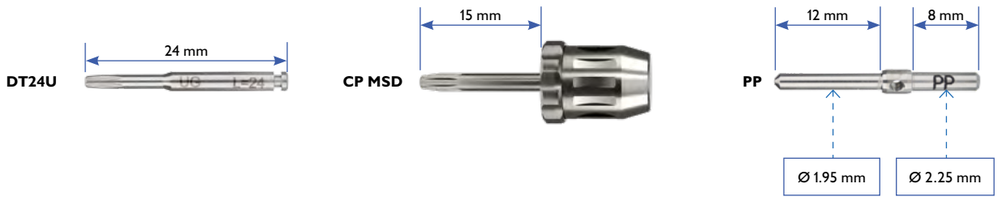

Racsnis kulcs, folyamatos nyomatékleolvasás 10-30-50-70 Ncm

A legnépszerűbb “hajló karú” kialakítás folyamatos nyomatékleolvasáshoz.
Konvencionális 7 mm átmérőjű eszközökhöz és adapterekhez.

	Racsnis kulcs			
	Cikkszám	Implantátum Ø (mm)	Megnevezés	Info
R N	**1000600**	3.35; 3.8; 4.2; 4.8	Racsnis kulcs	Folyamatos nyomatékleolvasás 10-30-50-70 Ncm



	Sebészeti adapter			
	Cikkszám	Implantátum Ø (mm)	Megnevezés	Info
R N	**1000274**	3.35; 3.8; 4.2; 4.8	Sebészeti adapter	RA és WH foglalattal



Sebészeti tálca

Sebészeti eszközök logikusan rendszerezett tárolására és sterilizálására (Autokláv). Extra eszközök tárolására, vagy augmentációs anyagok keveréséhez/ hidratálásához fém tálcával.
Munkahossz ellenőrző mm skálával.






Sebészeti tálca teljes
Cikkszám
STF




Sebészeti tálca üres
Cikkszám
ST

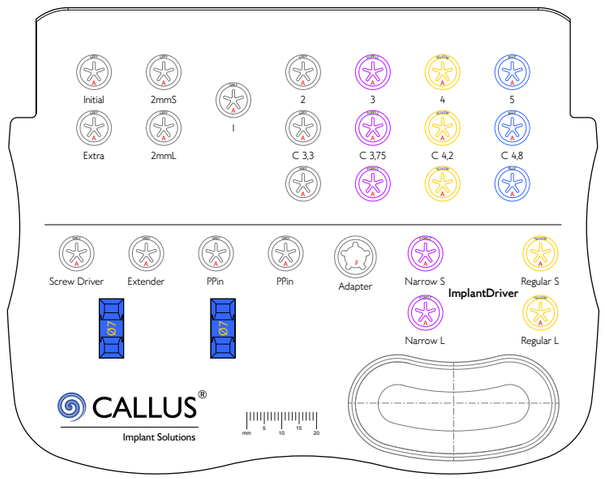

Protetikai tálca

PROTETIKAI MŰSZEREK



Protetikai csavarhúzók

Az opcionális termékeket a protetikai tálca nem tartalmazza, azok külön rendelhetőek.

R	N	Cikkszám	Implantátum Ø (mm)	Megnevezés	Hossz (mm)	Info
		DT20U	3.35; 3.8; 4.2; 4.8	Csavarhúzó	20	egyenes, rövid
		DT24U	3.35; 3.8; 4.2; 4.8	Csavarhúzó	24	egyenes, közepes
		DT35U	3.35; 3.8; 4.2; 4.8	Csavarhúzó	35	egyenes, hosszú
		DT20TB06	3.35; 3.8; 4.2; 4.8	Csavarhúzó	20	Szögtörött Titán bázis csavarhoz, egyenes, rövid (opcionális)
		DT24TB06	3.35; 3.8; 4.2; 4.8	Csavarhúzó	24	Szögtörött Titán bázis csavarhoz, egyenes, közepes
		DT35TB06	3.35; 3.8; 4.2; 4.8	Csavarhúzó	35	Szögtörött Titán bázis csavarhoz, egyenes, hosszú (opcionális)
		ID-MU	3.35; 3.8; 4.2; 4.8	Multi-Unit behajtó		RA foglalattal
		ID-LOC	3.35; 3.8; 4.2; 4.8	Locator behajtó		RA foglalattal



R	N	Cikkszám	Implantátum Ø (mm)	Megne-vezés	Info
		1000900-F	3.35; 3.8; 4.2; 4.8	Racsnis kulcs	Folyamatos nyomatékleolvasás (15-35-50 Ncm)



1000900-F

R	N	Cikkszám	Implantátum Ø (mm)	Megnevezés	Info
		1000235	3.35; 3.8; 4.2; 4.8	Protetikai adapter	RA foglalattal



1000235

Laboreszközök

Külön rendelhetőek.

R	N	Cikkszám	Implantátum Ø (mm)	Megnevezés
		PHLAB	3.35; 3.8; 4.2; 4.8	Fogtechnikai befogószerszám laborimplantátumhoz
		PHLOC	3.35; 3.8; 4.2; 4.8	DESSLoc® kivevő és behelyező eszköz



PHLAB **PHLOC**

PROTETIKAI TÁLCA

Protetikai tálca

Protetikai eszközök logikus, rendezett tárolására és sterilizálására (autokláv) szolgáló tálca. Protetikai kulcsok különböző hosszban elérhetőek.






Protetikai tálca teljes
Cikkszám
PTF

Protetikai tálca üres
Cikkszám
PT



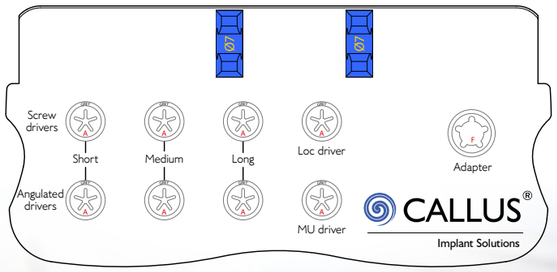



SINCE 1983

CALLUS®

IMPLANT SOLUTIONS

DenTi System Kft.
6600 Szentes, Bese L. u 8. Magyarország

WWW.CALLUSIMPLANT.HU
info@callusimplant.hu